ANLEITUNG ZUM ANBRINGEN

Wir erklären Ihnen nachfolgend, wie Sie den neuen SaHoMa®-II Halfterriemen korrekt anbringen.

Unser Tipp:

Zur Verwendung des SaHoMa®-II Halfterriemens empfehlen wir die Nutzung eines festsitzenden Halfters mit vielfältigen Verstellmöglichkeiten, um eine optimale Passform zu erzielen. Knotenhalfter oder sehr locker sitzende Halfter sind hierfür nicht geeignet, da sie zu einem zu lockeren Sitz der SaHoMa®-II Inhalationsmaske am Pferdekopf führen würden. Achten Sie bei der Wahl des Halfters außerdem auf eine gute Genickpolsterung für einen angenehmen Sitz bei Ihrem Pferd.

DER NEUE SAHOMA®-II HALFTERRIEMEN IM ÜBERBLICK

Sie haben die Möglichkeit, den SaHoMa®-II Halfterriemen vor oder nach dem Anbringen direkt am Pferdekopf auf die gewünschte Länge einzustellen. Bei Erstanwendung empfiehlt sich die Einstellung am Pferdekopf direkt. Nach erstmalig em Einstellen entfällt die erneute Anpassung beim nächsten Anlegen.

NEBUTEC® Innovative Inhalationsgeräte

Legen Sie Ihrem Pferd das gewünschte Halfter an und achten Sie dabei auf einen festen Sitz.
Sortieren Sie anschließend den SaHoMa®-II Halfterriemen vor dem Anbringen entsprechend der Abbildung.
Achten Sie darauf, dass es sich bei dem querführenden Riemen um den Nasenriemen handelt, der über die Pferdenase führt.
Die Schnellverschlüsse zeigen nach unten und die Karabiner nach oben.

Schritt 1:

Hängen Sie nun die Karabiner des SaHoMa®-II Halfterriemen einfach links und rechts am zuvor angelegten Halfter in die Ösen des Kehlriemens ein.

Schritt 2:

Rasten Sie nun die seitlichen Schnellverschlüsse links und rechts in die dafür vorgesehenen Aufnahmen am SaHoMa®-II Gehäuse mit einem Klick ein.

Schritt 3:

Über die seitliche Verstellmöglichkeit können Sie den SaHoMa®-II Halfterriemen nun enger oder weiter stellen, um für Ihr Pferd einen angenehmen Sitz mit optimalem Halt zu erzielen. Ziehen Sie am seitlichen Band, um es zu verkürzen und damit einen festeren Sitz der SaHoMa®-II Inhalationsmaske zu erreichen. Durch Anheben der Leiterschnalle löst sich das Band und der Sitz der Inhalations-maske lockert sich.

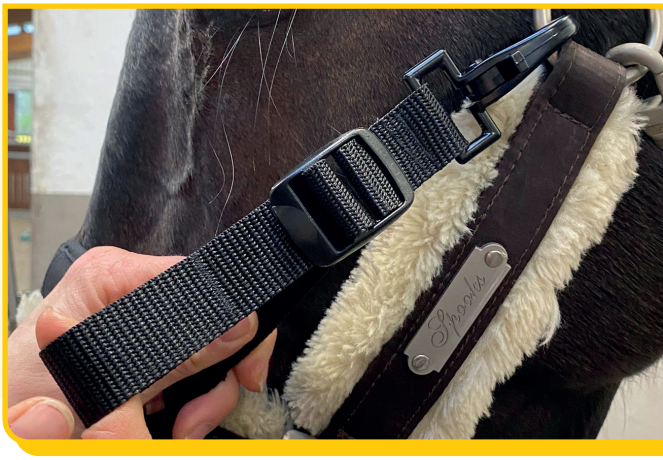

Möchten Sie den SaHoMa®-II Halfterriemen beim nächsten Mal erneut anbringen, führen Sie nur noch Schritt 1 bis 2 durch. Möglicherweise ist eine minimale Nachstellung, wie in Schritt 3 beschrieben, notwendig.